

ANGIOCORPORE

INSTITUTO DE MEDICINA CARDIOVASCULAR

www.angiocorpore.com.br

Tels: (013) 32080800

Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

1 - Dados do Exame

Nº do Exame 14985	Data de Instalação: 15/01/2016 10:45 Término: 16/01/2016 08:09	Código: 0LW-03030 Convênio: PETROBRAS
------------------------------------	---	--

2 - Paciente

Nome: KARINA PEREIRA VILAR DE SOUZA Sexo: F Fumante: Não	Altura: 172 Tel:	Idade: 36 Peso: 99 Fax:
Diagnóstico:		
Motivo do Exame:		

3 - Médico Solicitante

Nome: EVALDO DO AMARAL TEIXEIRA Clínica: .	Tel: Fax:
---	----------------------------

4 - Laudo Médico

a) Qualidade do Procedimento

Procedimento de qualidade técnica regular, tendo sido obtidas nas 21:22 hs. de exame um total de 70 medições, com percentagem de sucesso de 90% (63 medições válidas).

b) Pressões Sistólicas

As Cargas Pressóricas (% de medidas acima de 135 mmHg durante a vigília e 120 mmHg durante o sono) foram respectivamente de 0%, 0% e 0%, nos períodos total, vigília e sono. Admite-se como anormais valores superiores a 50%.

O maior valor de pressão sistólica obtido na vigília foi de 123 mmHg às 14:00 hs. e no sono de 99 mmHg às 23:30 hs.

A média da pressão sistólica nas 21:22 hs. de exame foi de 98 mmHg. Admite-se como anormais valores acima de 130 mmHg).

c) Pressões Diastólicas

As Cargas Pressóricas (% de medidas acima de 85 mmHg durante a vigília e 70 mmHg durante o sono) foram respectivamente de 2%, 2% e 0%, nos períodos total, vigília e sono. Admite-se como anormais valores superiores a 50%.

O maior valor de pressão diastólica obtido na vigília foi de 93 mmHg às 14:00 hs. e no sono de 60 mmHg às 01:33 hs.

A média da pressão diastólica nas 21:22 hs. de exame foi de 62 mmHg. Admite-se como anormais valores acima de 80 mmHg).

Conclusão

- Comportamento normal da pressão arterial

5 - Data e Assinatura

20/01/2016


PHILIPPE SACCAS
C.R.M.: 121093

Tabela das Medições

Nº do Exame 14985	Paciente: KARINA PEREIRA VILAR DE SOUZA Data de Instalação: 15/01/2016 10:45:45	Código: OLW-03030
------------------------------------	--	------------------------------------

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	10:47	103	73	87	30	84	Medição manual	49	01:33	99	60	78	39	80	
2	11:00	111	63	85	48	88		50	02:03	89	56	71	33	69	
3	11:15	102	66	82	36	68		51	02:30	94	51	70	43	64	
4	11:33	111	67	87	44	78		52	03:00	98	51	72	47	66	
5	12:00	95	60	77	35	68		53	03:30	93	53	72	40	67	
6	12:33	105	69	85	36	101		54	04:00	94	54	72	40	63	
7	12:45	96	60	77	36	74		55	04:33	88	52	68	36	64	
8	13:00	96	67	80	29	91		56	05:00	86	52	68	34	62	
9	13:33	105	68	85	37	80		57	05:30	92	53	71	39	60	
10	13:45	109	75	91	34	89		58	06:00	77	48	62	29	64	
11	14:00	123	93	107	30	81		59	06:33	94	52	71	42	63	
12	14:18	99	67	81	32	91		60	07:00	95	58	75	37	64	
13	14:33	102	70	84	32	84		61	07:15	103	63	81	40	63	
14	14:45	101	69	84	32	69		62	07:30	101	62	80	39	110	
15	15:00	103	63	81	40	67		63	08:00	84	70	76	14	72	
16	15:15	101	59	78	42	65		64	08:09						Aparelho desligado manualmente
17	15:30	99	63	80	36	74									
18	15:48	105	63	83	42	74									
19	16:00	111	68	88	43	78									
20	16:15	88	50	68	38	73									
21	16:30	88	63	74	25	74									
22	16:48	102	56	77	46	74									
23	17:45	86	74	79	12	90									
24	18:00	96	65	79	31	81									
25	18:15	101	67	82	34	72									
26	18:30	101	52	75	49	79									
27	18:45	101	57	77	44	75									
28	19:00	94	65	78	29	72									
29	19:15	105	72	87	33	80									
30	19:30	109	69	87	40	84									
31	19:45	107	66	85	41	85									
32	20:03	90	68	78	22	104									
33	20:15	96	72	83	24	85									
34	20:33	104	66	83	38	75									
35	20:45	104	68	84	36	75									
36	21:00	101	65	82	36	75									
37	21:15	111	65	86	46	74									
38	21:30	99	54	74	45	69									
39	21:45	97	51	72	46	73									
40	22:00	98	66	81	32	74									
41	22:15	92	54	71	38	71									
42	22:30	91	54	71	37	70									
43	22:45	105	50	75	55	72									
44	23:00	91	55	71	36	73									
45	23:30	99	57	77	42	72									
46	00:00	90	54	70	36	72									
47	00:30	80	49	63	31	77									
48	01:00	91	54	71	37	74									

ANGIOCORPORE

INSTITUTO DE MEDICINA CARDIOVASCULAR

www.angiocorpore.com.br

Tels: (013) 32080800

Análise Estatística

Nº do Exame 14985	Paciente: KARINA PEREIRA VILAR DE SOUZA Data de Instalação: 15/01/2016 10:45:45	Código: OLW-03030
------------------------------------	--	------------------------------------

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	70	
Medições Válidas:	63 = 90%	
2 - Valores Médios		Valores Aceitáveis
Período Total:	98 / 62 mmHg	até 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	101 / 64 mmHg	até 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	91 / 53 mmHg	até 120 / 70 mmHg
Pressão Matinal:	96 / 63 mmHg	
Ascenso Matinal*:	8 mmHg	
Descenso de P.A. no Sono:	10% / 17%	acima de 10% / 10%
Carga Pressórica** na Vigília:	0% / 2%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	0% / 0%	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	0% / 2%	até 50% / 50%
* Ascenso Matinal: Diferença entre a média da pressão matinal e a média da menor pressão no sono. ** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.		
3 - Valores Máximos em mmHg		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	123 mmHg às 14:00 hs	
PAD:	93 mmHg às 14:00 hs	
PAM:	107 mmHg às 14:00 hs	
PP:	55 mmHg às 22:45 hs	
Período do Sono:		
PAS:	99 mmHg às 23:30 hs	
PAD:	60 mmHg às 01:33 hs	
PAM:	78 mmHg às 01:33 hs	
PP:	47 mmHg às 03:00 hs	
4 - Valores Mínimos em mmHg		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	84 mmHg às 08:00 hs	
PAD:	50 mmHg às 16:15 hs	
PAM:	68 mmHg às 16:15 hs	
PP:	12 mmHg às 17:45 hs	
Período do Sono:		
PAS:	77 mmHg às 06:00 hs	
PAD:	48 mmHg às 06:00 hs	
PAM:	62 mmHg às 06:00 hs	
PP:	29 mmHg às 06:00 hs	
5 - Desvio Padrão das medições de P.A em mmHg		Valores Aceitáveis
Período Total:	8,3 / 8,4	
Período da Vigília:	7,5 / 7,7	até 12,0 / 9,0
Período do Sono:	6,1 / 3,0	até 10,0 / 8,0

Gráfico das Pressões

Nº do Exame 14985	Paciente: KARINA PEREIRA VILAR DE SOUZA Data de Instalação: 15/01/2016 10:45:45	Código: OLW-03030
------------------------------------	--	------------------------------------

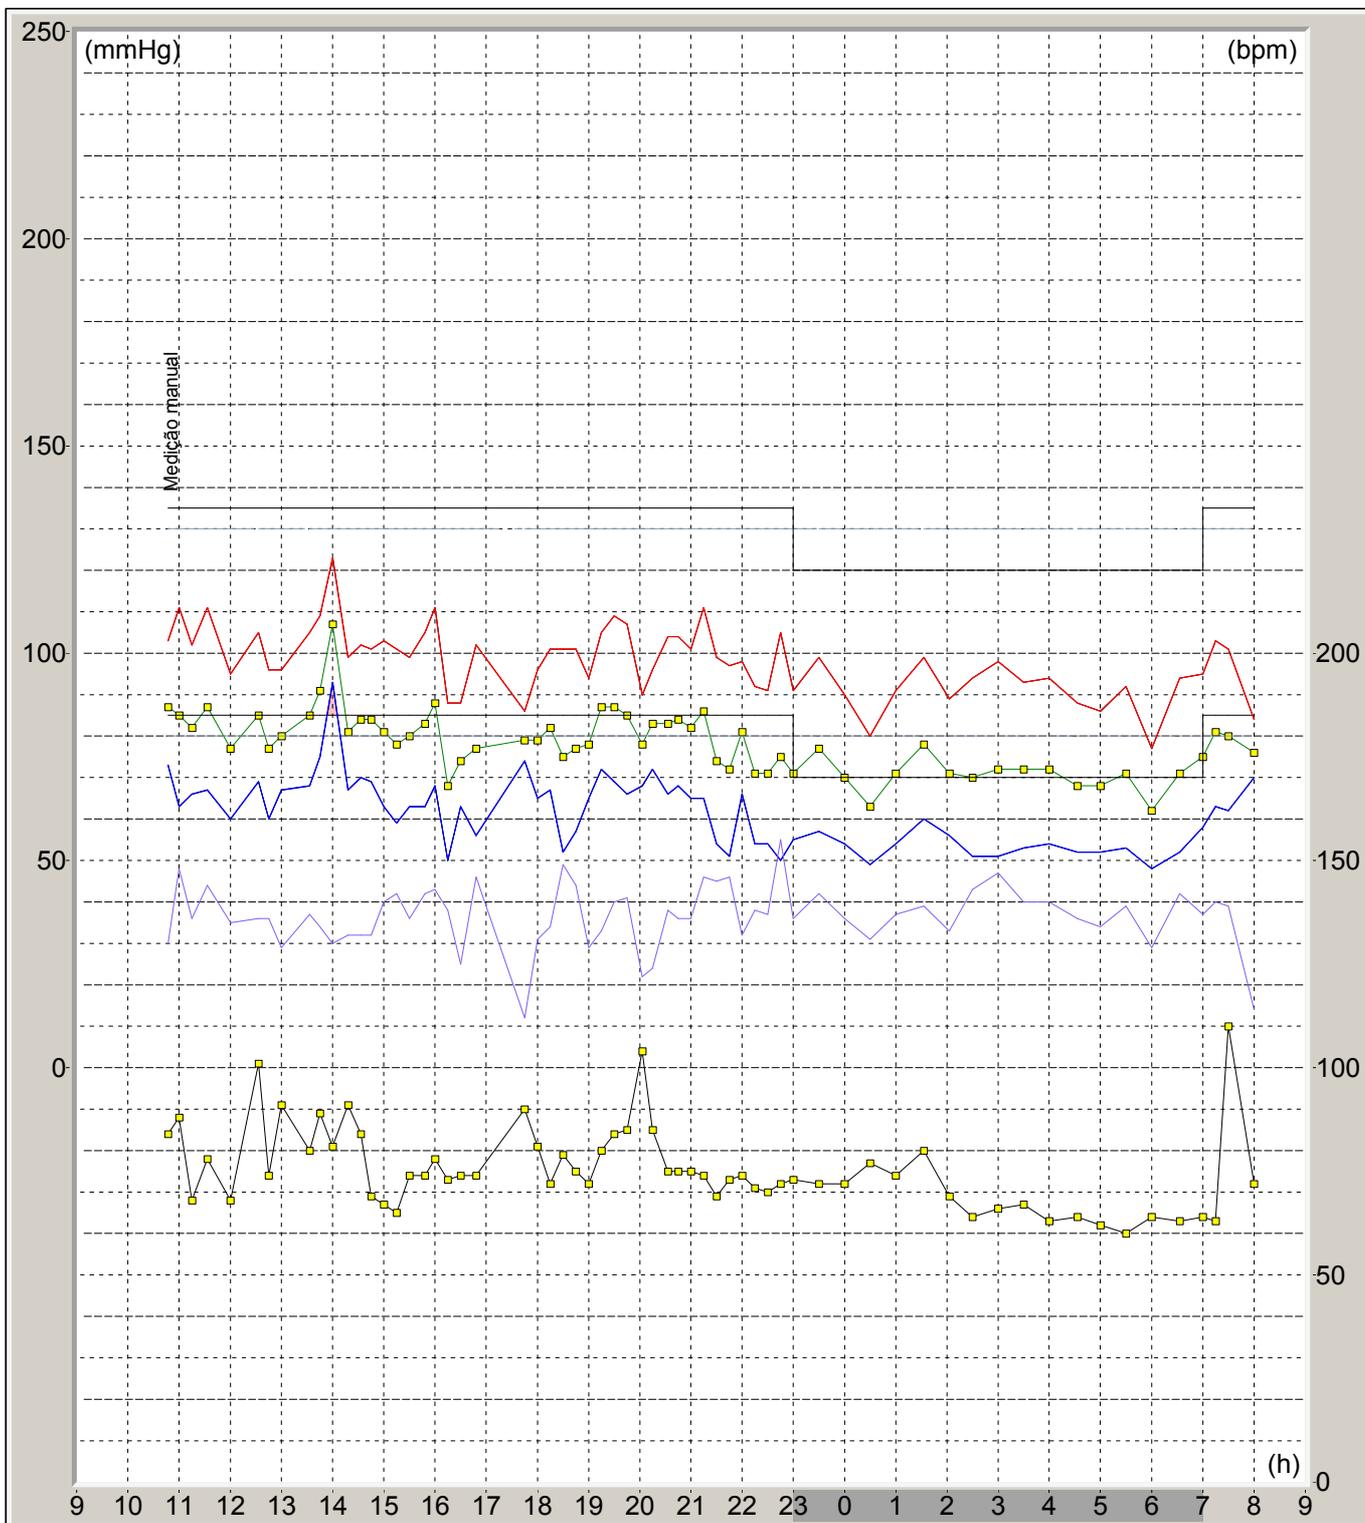


Gráfico de Tendências

Nº do Exame 14985	Paciente: KARINA PEREIRA VILAR DE SOUZA Data de Instalação: 15/01/2016 10:45:45	Código: 0LW-03030
------------------------------------	--	------------------------------------


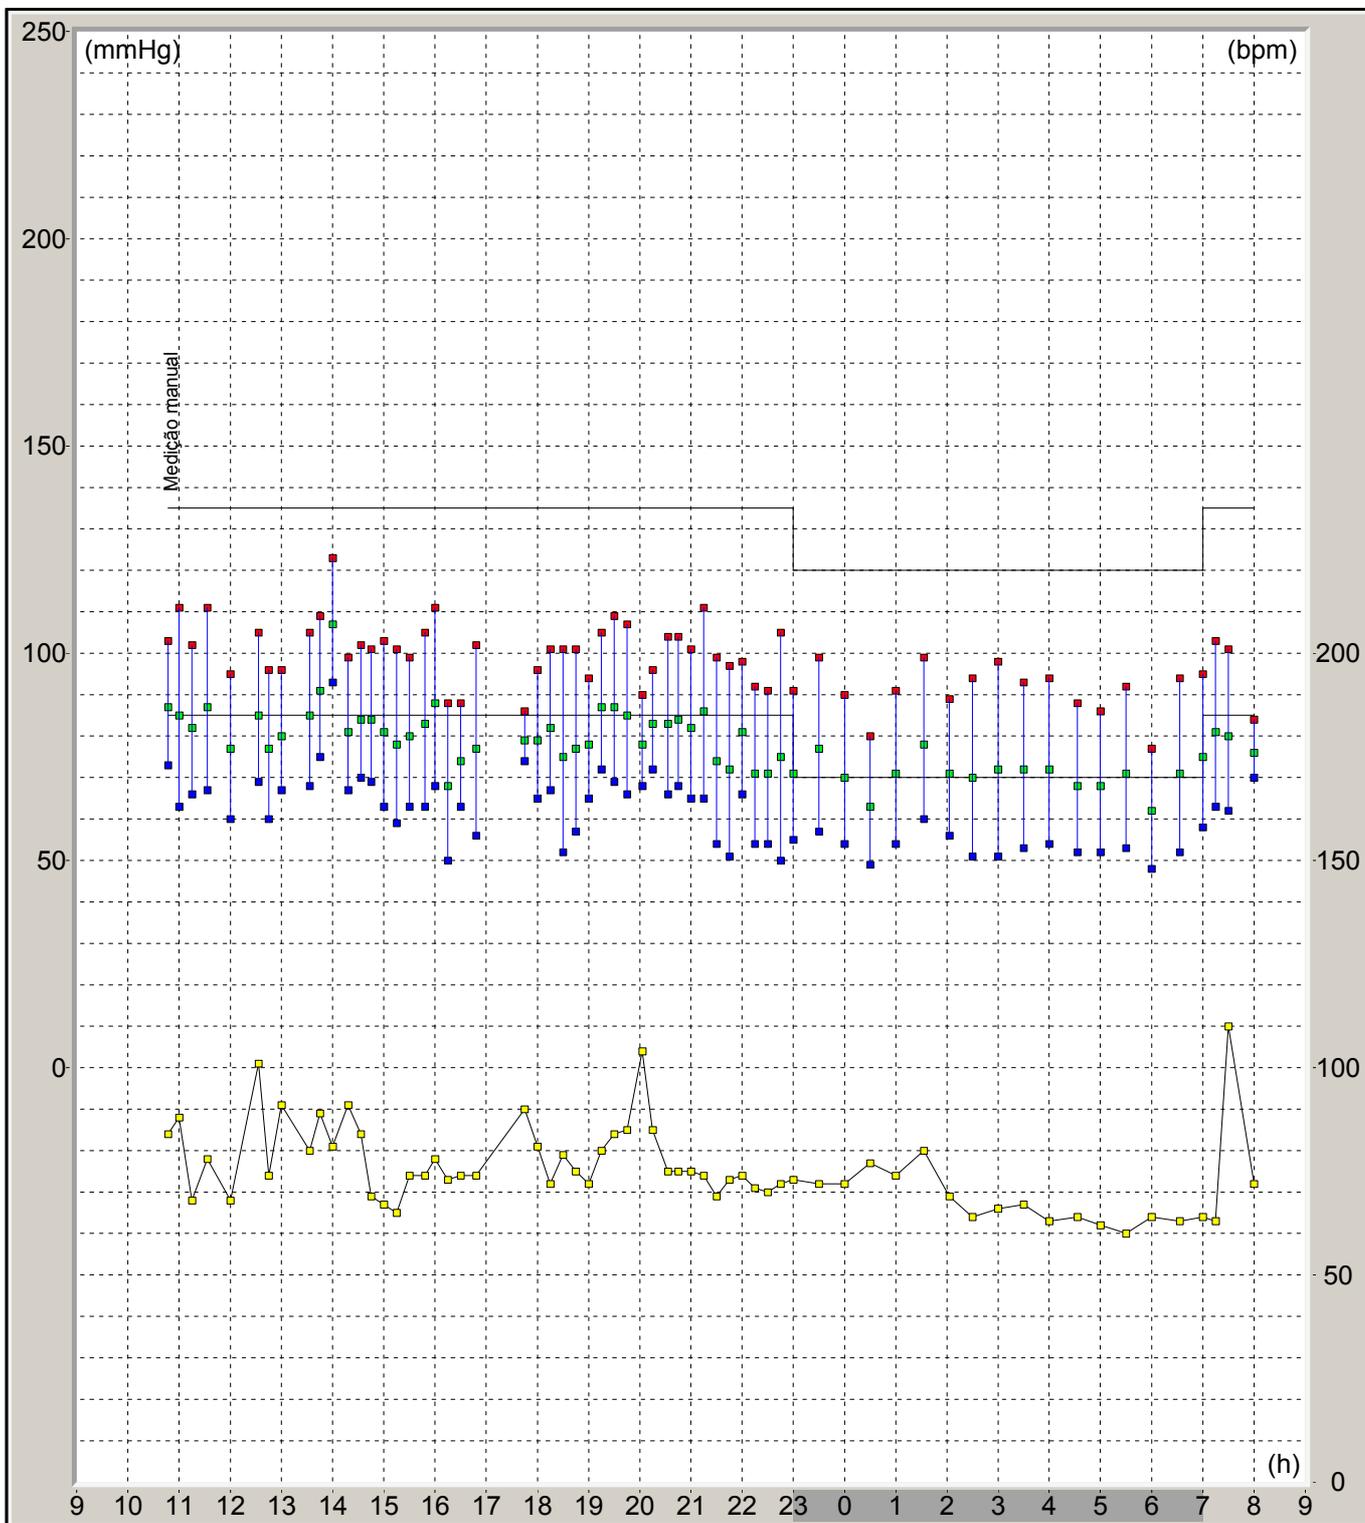


Gráfico de Correlação

Nº do Exame 14985	Paciente: KARINA PEREIRA VILAR DE SOUZA Data de Instalação: 15/01/2016 10:45:45	Código: 0LW-03030
------------------------------------	--	------------------------------------

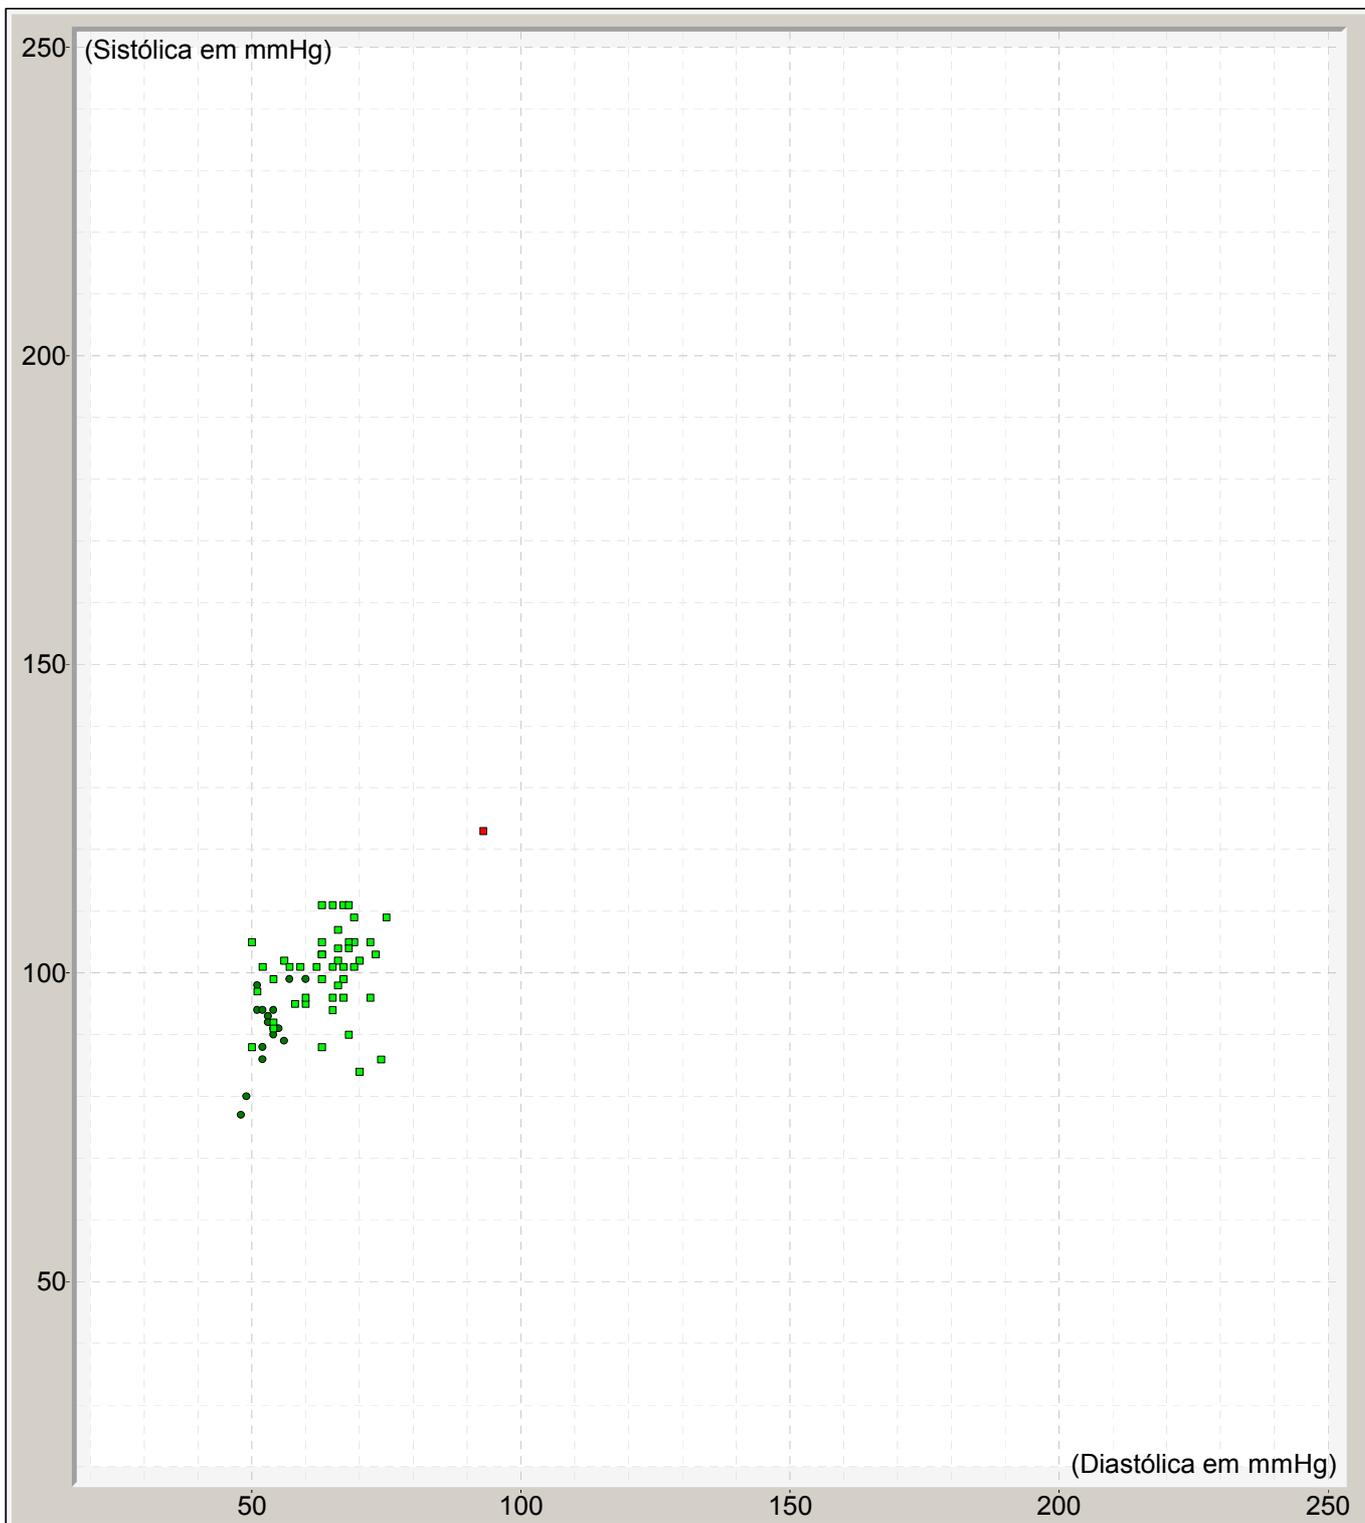

Histogramas

Nº do Exame 14985	Paciente: KARINA PEREIRA VILAR DE SOUZA Data de Instalação: 15/01/2016 10:45:45	Código: OLW-03030
------------------------------------	--	------------------------------------

